



Stanice se zásuvkou s verzí FW 529943 / R1.10 je zásuvka z výroby zapojena na **RELAY 3**
(**RELAY 3 - dle štítku RX, nicméně výstup RX je přehozen s výstupem pH**)
(Pozn. V případě stanice VD BASIC + VD EXACT platí stejná situace při zapojení externích pump)



!!! OPRAVA – je potřeba pouze přepojit konektor z RELAY 3 na RELAY 1 !!!

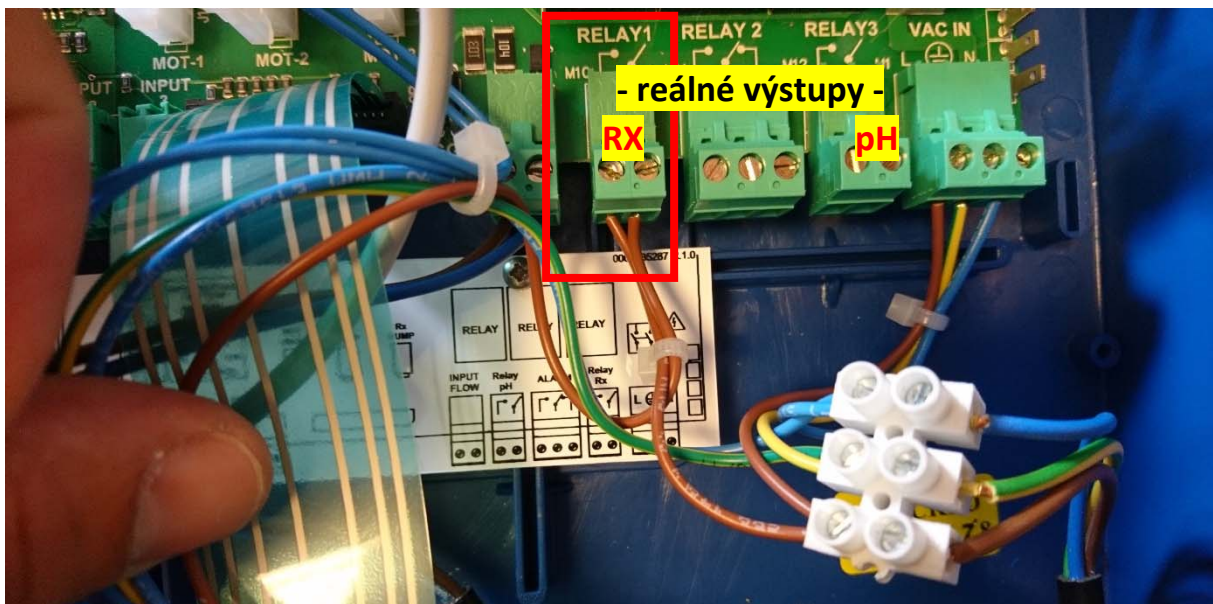

Není-li připojena průtoková klapka, je třeba doplnit "klemu" na svorku INPUT 1 = NOT USED (štítek)

